intrauma®

FR



BATCerclage System

Données et images
Intrauma S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et à la finition des produits présentés et décrits dans ce catalogue sans préavis.
Les images constituent des exemples illustratifs présentées à titre informatif.
Les informations affichées concernant les caractéristiques générales des produits présentés ne sont qu'à titre indicatif.
Ces informations ne constituent en aucun cas une description des caractéristiques spécifiques par le fabricant.
Nous invitons donc le client à toujours contacter la société Intrauma S.p.A. pour obtenir des informations complètes sur les caractéristiques spécifiques.
© Le contenu des pages de ce catalogue est protégé par le droit d'auteur. La reproduction des contenus est possible si elle est expressément autorisée par Intrauma S.p.A.
La copie et la distribution de ce catalogue ne sont pas autorisées sans autorisation préalable.


BATCerclage System.


Le câble **BATCable** est un système de cerclage en alliage de Titane et de Cobalt-Chrome d'un diamètre de 1.8mm.

Les câbles en titane sont compatibles avec toutes les implantations et sont particulièrement recommandés en cas de patients allergiques au chrome.

Ce système a été conçu pour offrir aux chirurgiens certains avantages significatifs :

- Câble en alliage de Titane et de Cobalt-Chrome de Ø1.8mm
- Technique chirurgicale simplifiée.
- Instruments dédiés.

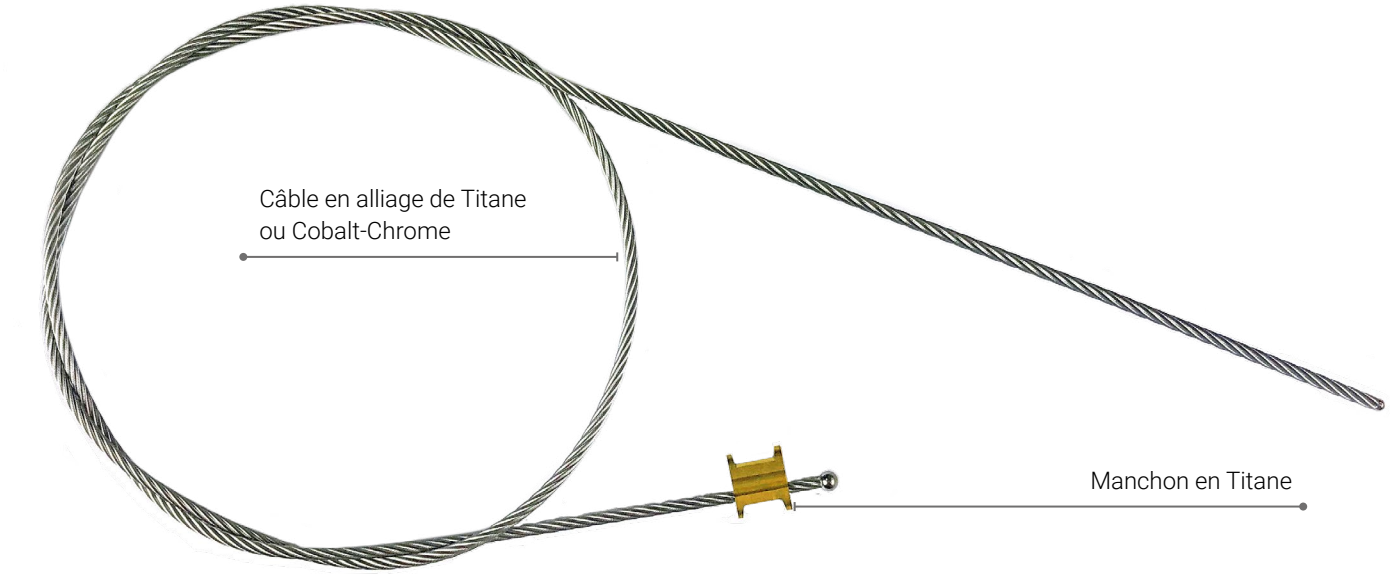



Croisement ordinaire à droite 7 x 19

Technique chirurgicale.

• 1

Insérez le passe-câble (S3235 ou S3236).




• 2

Insérez le câble dans le passe-câble, puis retirez ce dernier.


• 3

Insérez le câble dans le manchon.

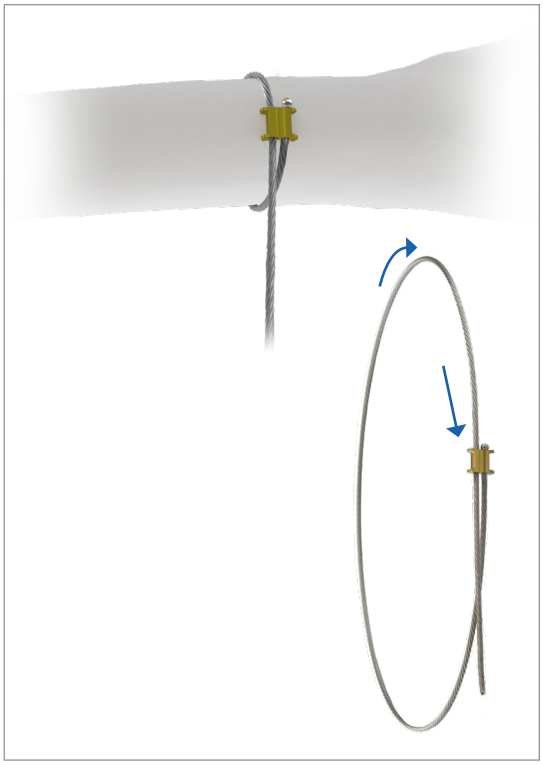

• **4**

Insérez la pince (S3233) sur le câble.

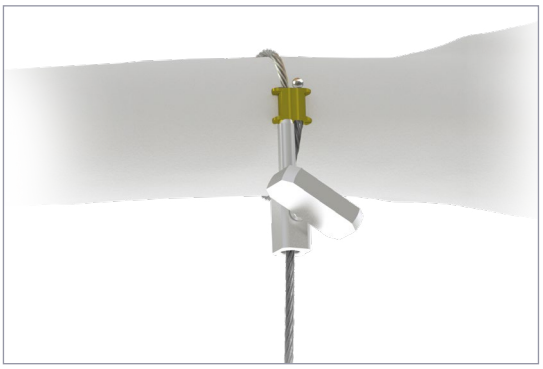

• **5**

Veillez à ce que l'anneau (B) du tendeur (S3232) se trouve à l'extrémité supérieure du fil.

• **6**

Insérez le câble dans le tendeur.
Assurez-vous que l'extrémité du tendeur, la pince et le manchon du câble sont en contact.
Vissez le bouton (A) pour bloquer le câble.



• **7**

Vissez l'anneau (B) pour régler la traction du câble.
Vissez l'écrou papillon de la pince (C).



• **8**

Dévissez le bouton (A) et retirez le tendeur.


• **9**

Cerclages multiples
Il est possible de placer plusieurs câbles de cerclage avant le sertissage à l'aide de pinces supplémentaires.
Au besoin, les câbles peuvent être retendus en suivant les étapes 5. à 8.




· 10

Pincez le manchon à l'aide de la pince (S3231).
Le sertissage est réussi lorsque le levier (D) émet un clic au moment du déverrouillage.
Desserrez le papillon de la pince et retirez-le.

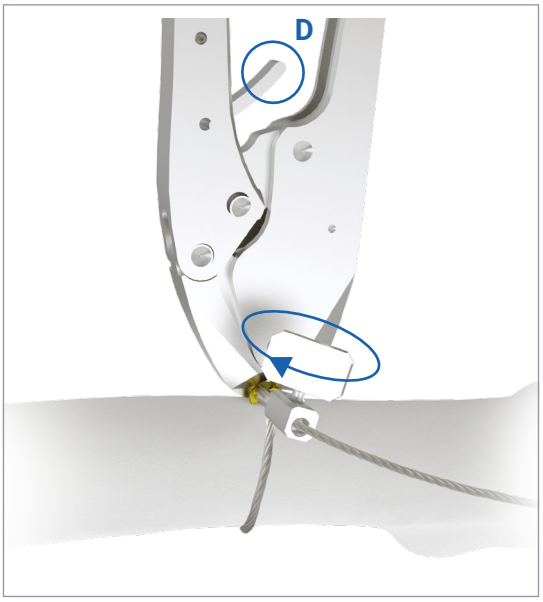

· 11

Coupez le câble excédentaire à l'aide de la pince coupante (S3237).

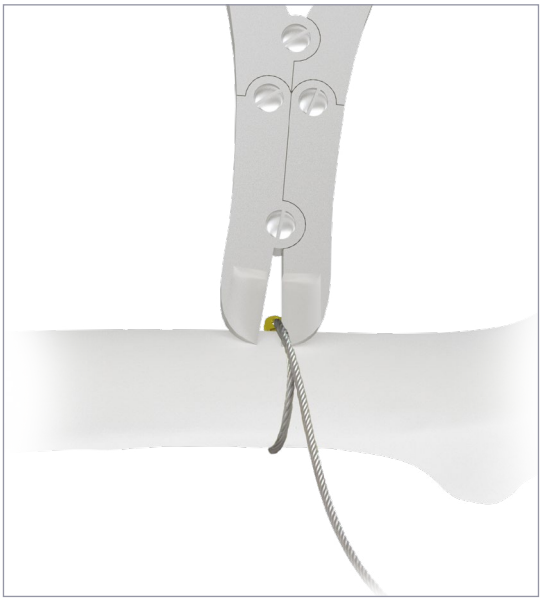

Informations pour les commandes.

CE 0426

Ref.	Description	Ø (mm)	Matériel
32.3102	BAT Cable Ti	1.8	Titane Ti6Al4V - ISO 5832/3
32.3107	BAT Cable CoCr	1.8	CoCr L605 - ISO 5832/5
32.3103*	Goupille à œillet conique Ø3.6mm		
32.3104*	Goupille à œillet conique Ø4.8mm		
32.3105*	Goupille à œillet filetée conique Ø4.8mm		
32.3106*	Goupille à œillet pour trou Rail Ø4.8mm		

* Goupilles compatibles avec les implants Intrauma uniquement

Matériaux:


Manchon | Titane Gr. 2 - ISO 5832-2

Cerclage

Instrumentation complète

REF. S3230
Boîte à outils de cerclage - 1 pce

REF. S3231
Machine à sertir pour serre-câbles - 1 pce.

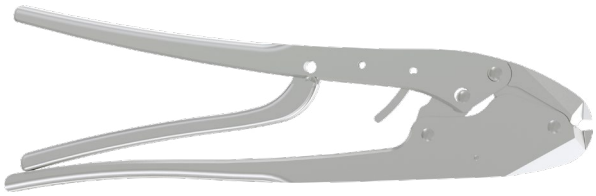

REF. S3232
Tendeur pour câble de cerclage - 1 pce.



REF. S3233
Pince pour câble de cerclage - 3 pce.




REF. S3235
Passe-câble moyen recourbé - 1 pce



REF. S3236
Passe-câble grand recourbé - 1 pce



REF. S3237
Pince coupante latérale - 1 pce.

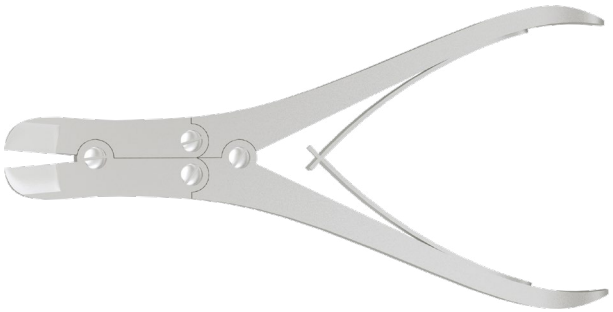

REF. S3234
Tendeur pour câble de cerclage - 1 pce.



REF. S3238
Batteur de broche - 1 pce



REF. SET Cerclage
Instrumentation complète cerclage

/ NOTE

CAT053FR - Rev. 1 Janvier 2024 - © Intrauma S.p.A.

Intrauma S.p.A.

Siège social et administratif : Via Genova, 19 - 10098 Rivoli (TO)
Tél. : +39 011.95.39.496 | **Fax :** +39 011.95.88.385 | **N° TVA :** 09270550016 | intrauma.com | info@intrauma.com